
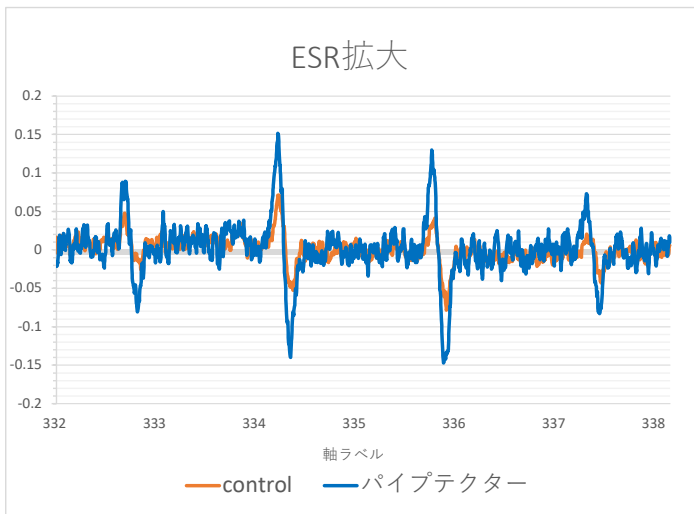


ESR測定データのグラフ化

実施場所：名古屋大学

実施期間：2020年7月14日～16日

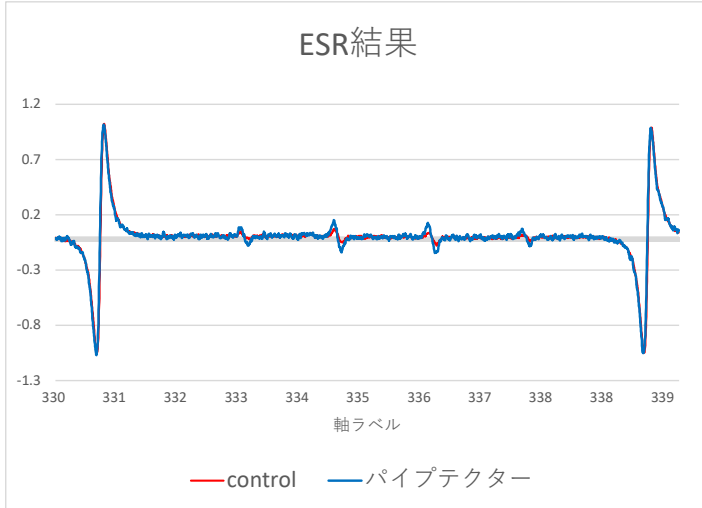

TEMPOの0.16 mM溶液を標準として、
定量致しました。
それぞれの溶液中のOHラジカルの濃度は、

Control : 0.30 μ M
パイプテクター : 0.47 μ M

